

Система сертификации ГОСТ Р

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЖ38 действителен до 11.04.2016 г.
125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел: 8(499)150-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю

Руководитель ИЛ ГСО

А.В. Мельникова

Протокол


испытаний холодного клинкового оружия

(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)

№ ХО-1716 от 28.08.2014 г.

Всего страниц -1

1. Заявитель: ООО «ПромТо» (Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.25, литер А, пом. 30/1).
2. Наименование продукции: ножи нескладные из набора арт. «M9481N».

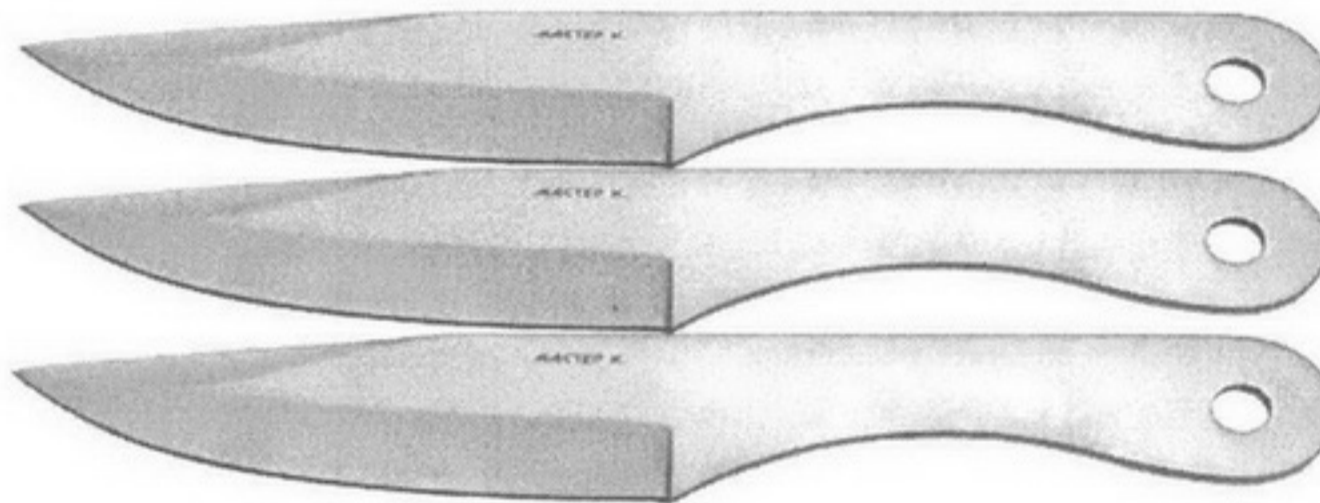

3. Производитель: «МАСТЕР К.» (Китай).
4. Основание для проведения испытаний: Решение № ОС ГСО/724 от 27.08.2014 г.
5. Акт отбора образцов: № 322 от 28.08.2014 г.
6. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:



Наименование характеристик	Требования по ГОСТ Р 51644-2000	Результаты испытаний
общая длина, мм		154,0
длина клинка, мм	Не более 90,0	77,0
длина рукояти, мм		77,0
толщина обуха, мм		4,0
ширина клинка, мм		25,3

7. Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено:

- ножи нескладные из набора арт. «M9481N» соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкурорезные. Общие технические условия» и являются конструктивно сходными с холодным оружием изделиями - **ножами разделочными**, не относящимися к оружию (длина клинка менее 90,0 мм).

Примечание: Ножи из набора арт. «M9481» являются аналогами ножей из набора арт. «M9481N».

Испытатель


подпись

Б.З. Сагдиев
инициалы, фамилия