

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЖ38, действителен до 11.04.2016 г.
125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru


Утверждаю
Руководитель ИЦ ГСО



**Протокол испытаний
холодного клинкового оружия (конструктивно сходных
с холодным оружием изделий)
№ ХО-53. от 21. 01.2013. г.**

Всего страниц -1

- 1 Заявитель: ООО «Стройком Консалт» (г. Санкт-Петербург)
- 2 Наименование продукции: нож складной арт. «М9514».

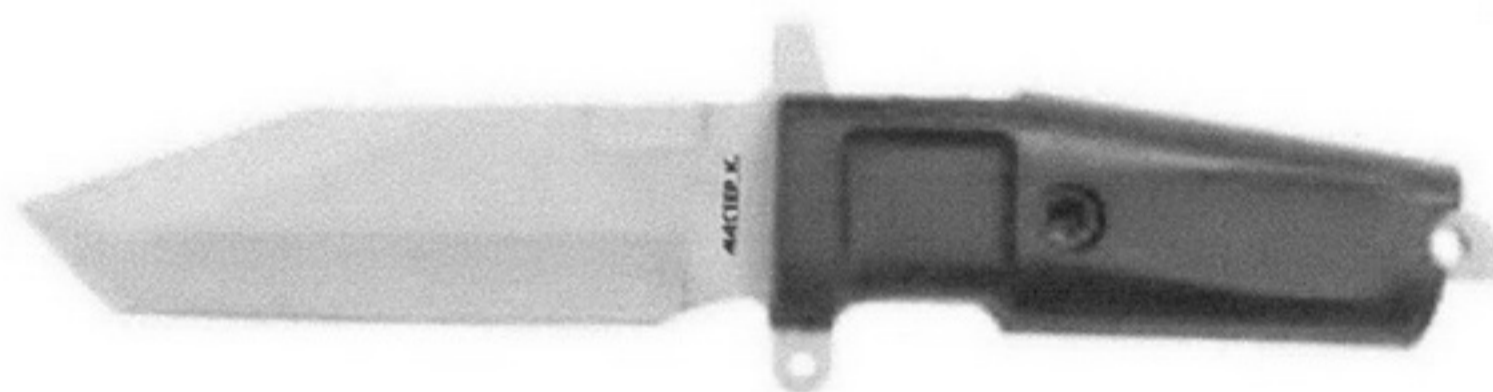

- 3 Производитель: фирма «МАСТЕР К» (Китай).
- 4 Основание для проведения испытаний: Решение № ОС ГСО/39 от 21.01.2013 г.
- 5 Акт отбора образцов: № 20 от 21.01.2013 г.
- 6 Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Общая длина, мм	200,0
Длина клинка, мм	105,0
Толщина обуха, мм	3,0
Ширина клинка, мм	31,0
Длина рукояти, мм	95,0
Толщина пяты клинка, мм	3,0

7 Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено:

- нож складной арт. М9514 является конструктивно сходным с холодным оружием изделием, не относящимся к оружию (толщина пяты клинка, используемой в качестве ограничителя, не более 3,5 мм);

- указанный нож соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи. Ножи разделочные и шкуроемные Общие технические условия» и является ножом разделочным.

Испытатель

А.В. Медведев

Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец.

Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории.